CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN A.C.
LABORATORIO DE METROLOGÍA
CARTA DE TRAZABILIDAD
VOLUMEN "ACREDITACIÓN: V-12"
MR-CV-5.6-19.9
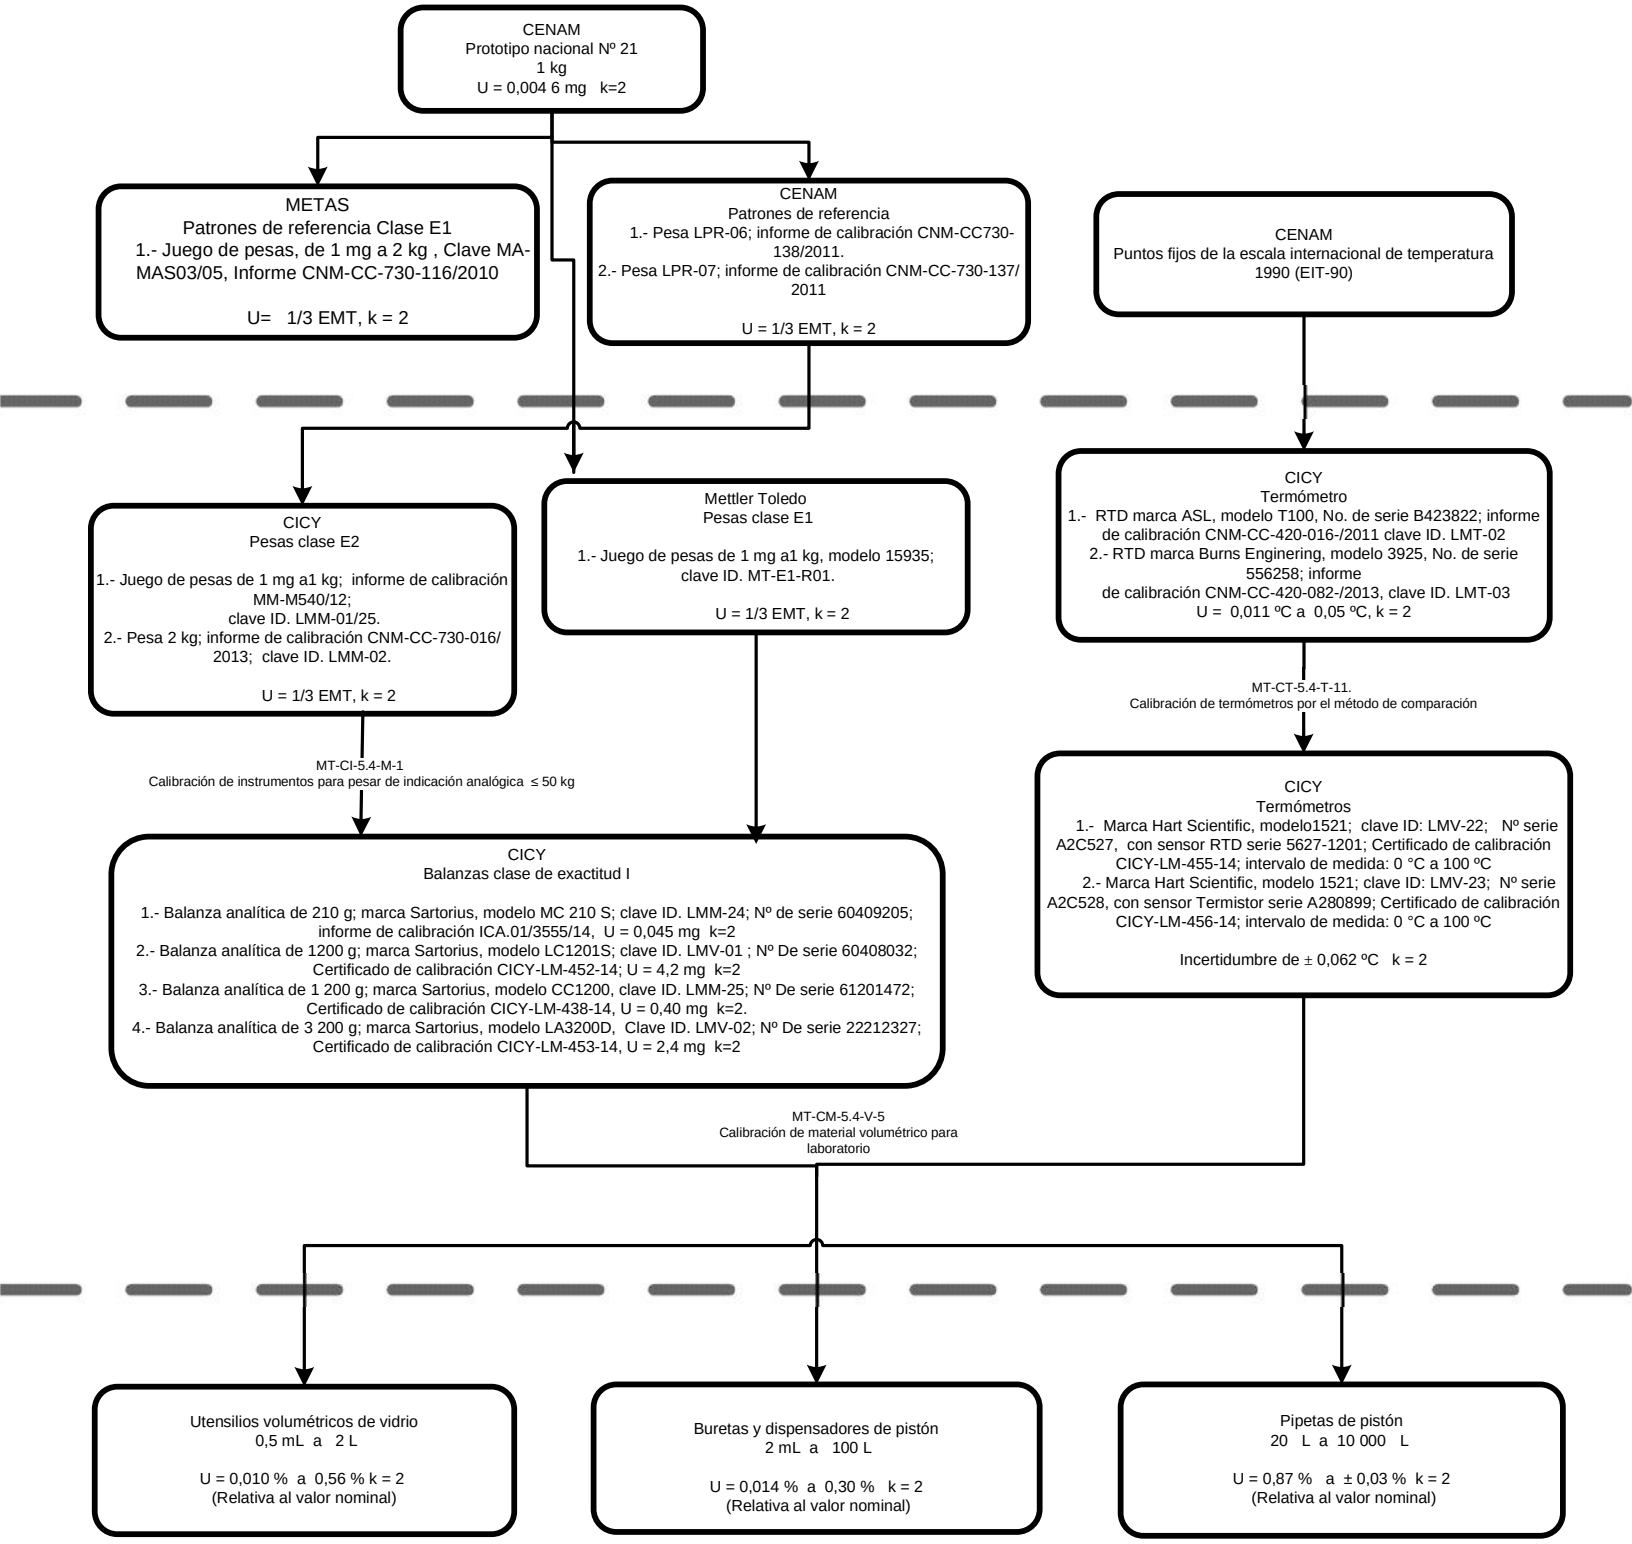
Calibración de material de vidrio y pipetas de pistón
método de medida gravimétrico